



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 17072

03.04.2024

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 13 KALEM MOBİLYA MALZEMESİ ALIMI İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :17.04.2024 11:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, 0432 215 19 16 nolu faksa fakslanması veya "vanadsm.satinalma@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Mehmet AKTAŞ
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	BEYAZ MDF 210X280	15	Adet		
2	ARKALIK BEYAZ 210X280	14	Adet		
3	BEYAZ MDF 8m	3	Adet		
4	RAF PİMİ	15	Adet		
5	MOBİLYA AYAĞI 10 luk	80	Adet		
6	ASKILIK	70	Adet		
7	MENTEŞE	200	Adet		
8	1.LİK VİDALAR	2	PAKET		
9	5.LİK VİDALARI	3	PAKET		
10	3.LÜK VİDALARI	1	PAKET		
11	ARKALIK ÇİVİSİ	4	Kilogram		
12	MOBİLYA KENAR BANT	2	TOP		
13	MAKİNE YAPIŞTIRICILAR	15	Kilogram		
				Toplam	

*** Kısmi Teklife ağıttır.**

* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.

*Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

* Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

* Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

* Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.

* Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.

* Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.

* Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.

* Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.

* Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

* Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
MARANGOZ MALZEMELERİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

MDF - LAM 18 mm Teknik Özellikleri

1. 210x280 cm . ebatlarında 18 mm kalınlığında istenen renklerde getirilecektir.
2. Tabakalar halinde getirilecektir.
3. Tabaka kenarları temiz kesimli olarak getirilecektir .
4. Eğilme dayanımı TS 64EN 310 standartlarında olacaktır .
5. TSE standartlarına uyumlu özellikte olmalıdır .
- 6- Tabaka ağırlığı minimum 70 kg olmalıdır.

MDF 8 mm . Teknik Özellikleri

1. 210 x 280 cm . ebatlarında 8 mm kalınlığında istenen renklerde getirilecektir.
2. Tabakalar halinde getirilecektir .
- 3 . Tabaka kenarları temiz kesimli olarak getirilecektir.
4. TSE standartlarına uyumlu özellikte olmalıdır.
- 5- Tabaka ağırlığı minimum 40 kg olmalıdır

MDF 4 mm . (Arkalık) Teknik Özellikleri

1. 210 x 280 cm . ebatlarında 4 mm kalınlığında olacaktır.
2. Tabakalar halinde getirilecektir .
3. Tabaka kenarları temiz kesimli olarak getirilecektir . Bir tarafı beyaz renk olacaktır.
4. TSE standartlarına uyumlu özellikte olmalıdır

Raf Pimi Teknik Özellikleri

- 1 . Metal malzemeden olacaktır .
- 2 . Çivili yapıda olacaktır .
- 3 . 18 mm. yüksekliğinde, 12 mm. genişliğinde olacaktır .
4. 100'er adetlik paketler halinde getirilecektir .

VAN AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
İdari ve Mali Hizmetler
Müdür Yardımcısı
İbrahim İMAN

Sevket ERGÜÇ
Teknisyen
Sicil No:115
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Emin Akbulak

Dolap Ayağı Teknik Özellikleri

1. 10 cm . ölçülerinde olmak üzere , istenmiş olan ölçülerde getirilecektir .
2. Ayarlanabilir özellikte olmalıdır .
3. En az 1 mm . et kalınlığında sac malzemeden imal edilmiş olmalıdır
4. Tabla kısımları sağlam yapıda olmalıdır .
5. Paslanmaya karşı dirençli yapıda olmalıdır.
6. TSE standartlarına uyumlu özellikte malzeme olmalıdır.

Vida (Muhtelif Ebatlarda) Teknik Özellikleri

1. Mobilya vidaları muhtelif ebatlarda olacaktır.
2. 1'lik vida olarak getirilecektir .
3. 1000'er adetlik paket / kutular halinde getirilecektir.
4. Sertleştirilmiş ve tamperlenmiş özellikte olacaklardır.
5. Yüksek kırılma değerine sahip yapıda olmalıdırlar.
6. Çinko kaplama olmalıdır.
7. TSE standartlarına uyumlu özellikte malzeme olmalıdır.


Vida (Muhtelif Ebatlarda) Teknik Özellikleri

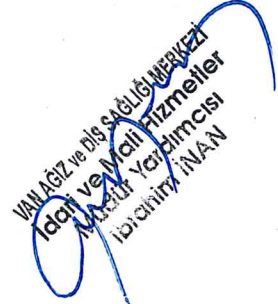
1. Mobilya vidaları muhtelif ebatlarda olacaktır.
2. 3'lük vida olarak getirilecektir .
3. 1000'er adetlik paket / kutular halinde getirilecektir.
4. Sertleştirilmiş ve tamperlenmiş özellikte olacaklardır.
5. Yüksek kırılma değerine sahip yapıda olmalıdırlar.
6. Çinko kaplama olmalıdır.
7. TSE standartlarına uyumlu özellikte malzeme olmalıdır.

Vida (Muhtelif Ebatlarda) Teknik Özellikleri

1. Mobilya vidaları muhtelif ebatlarda olacaktır.
2. 5'lik vida olarak getirilecektir .
3. 1000'er adetlik paket / kutular halinde getirilecektir.
4. Sertleştirilmiş ve tamperlenmiş özellikte olacaklardır.
5. Yüksek kırılma değerine sahip yapıda olmalıdırlar.
6. Çinko kaplama olmalıdır.
7. TSE standartlarına uyumlu özellikte malzeme olmalıdır.

EMİN ALKAYI

Seyket ERGÜÇ
Teknisyen
Sicil No:115
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi


VAN AĞIZ ve Diş Sağlığı Merkezi
İdari ve Mali Hizmetler
Müdür Yardımcısı
İbrahim İNAN


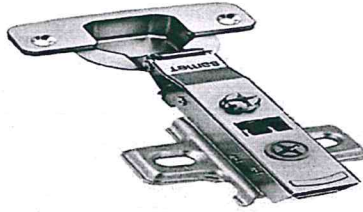
Askılık Teknik Özellikleri

1. Zamak malzemedan , krom kaplama dolap askısı olacaktır .
2. TSE standartlarına uyumlu özellikte olmalıdır .



Menteşe Teknik özellikleri

- 1- 110 cm açılma özellikli düz menteşe olmalıdır.
- 2- Paslanmaya karşı dayanıklı nikel kaplama olmalıdır.
- 3- Menteşe gövdesi ve çanağı çelik olmalıdır.



Arkalık Çivisi

- 1- ± 3 cm 'lik başlı paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

Mobilya Kenar Bant

- 1- PVC minimum 0,4 mm kalınlığında olmalıdır.
- 2- 20 mm genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda olmalıdır.
- 3- Alınacak MDF ye uyumlu renk ve parlaklıkta olmalıdır.

Ebatlama Makinası Tutkalı(makine Yapıştırıcılar)

- 1- Mdf Kenar bantlama makinasında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Dayanıklı ve kolay işlem sunmalıdır.

VAN AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
İçerik ve Mali Hizmetler
Müdür Yardımcısı
İbrahim İNAN

Emin Akbulut
M

Seydi ERGÜÇ
Teknisyen
Sicil No:115
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

S. Akbulut